


# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx<sup>®</sup>

## Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit PER USODIAGNOSTICO IN VITRO

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento all'*Insero della confezione di TruSeq Custom Amplicon Kit Dx* (documento n. 1000000029772).

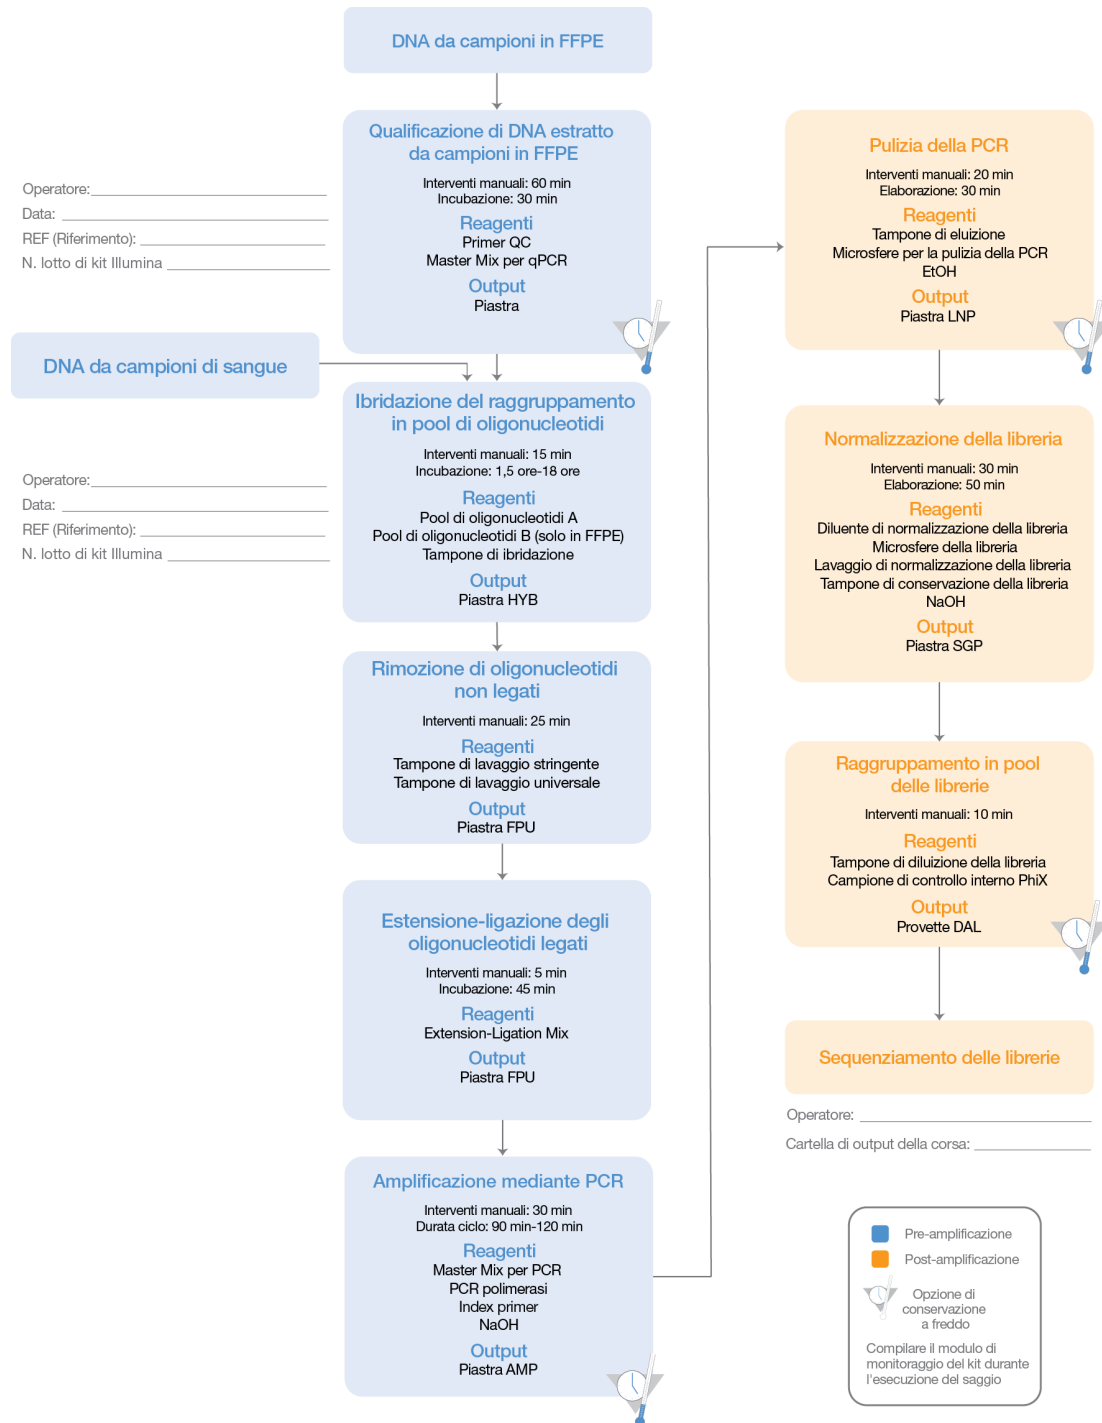

# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx

## Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit

[Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota]



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566)


+1.858.202.4566 (fuori dal Nord America)

techsupport@illumina.com

[www.illumina.com](http://www.illumina.com)

Documento n. 1000000039154 v02 ITA

Pagina 2 di 2



Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

Paesi Bassi



Sponsor Australiano:

Illumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building

Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000

Australia